


腸内細菌検査容器の有効期限

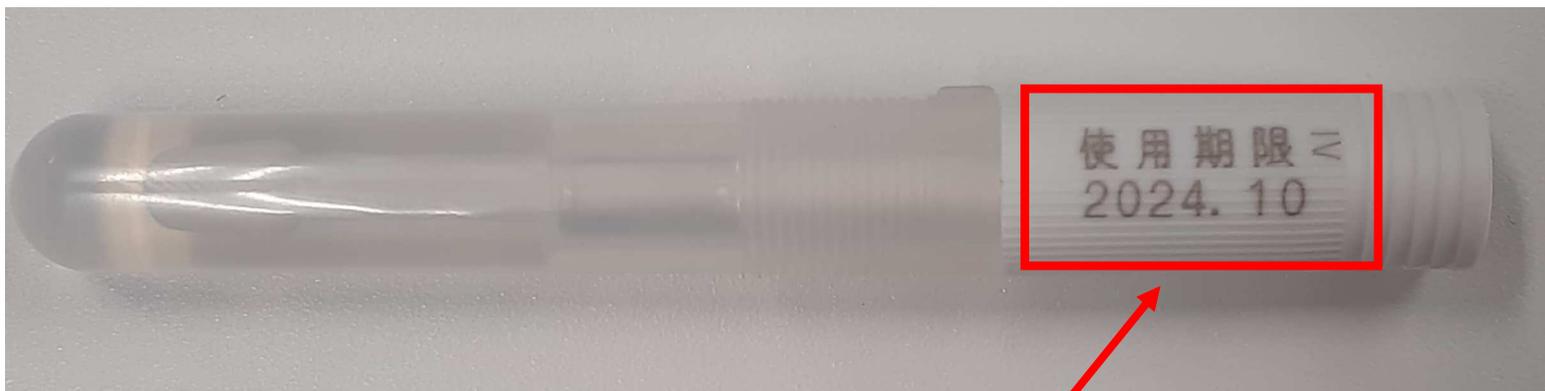

(例) 上図の容器の使用期限は
2024年10月末までとなります。
容器ごとに使用期限が異なる場合が
ございますので、
使用前に必ずご確認ください。